


Znak: AE/ZP-27-27/15

Tarnów, 2015-05- 12

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 207.000 EURO na dostawę myjni-dezynsektorów do basenów i kaczek – 2 szt. Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Załącznika Nr 7 punkt 5.** Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie myjni o wysokości 1775 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?
2. **Dotyczy Załącznika Nr 7 punkt 6.** Czy Zamawiający dopuści do postępowania urządzenie o pojemności 1 basen z pokrywą (zamiennie za basen nocnik dla dzieci – w cenie oferty 10 nocników, które mogą być myte w zaoferowanej myjni) i 1 kaczka na mocz lub 2 kaczki lub 1 miska do toalety pacjenta lub 2 miski nerkowate” lub 1 pojemnik na mocz?
3. **Dotyczy Załącznika Nr 7 punkt 5.** Czy Zamawiający dopuści do postępowania urządzenie o wysokości 855 mm?
4. **Dotyczy Załącznika Nr 7 punkt 5.** Czy Zamawiający dopuści do postępowania urządzenie o wysokości 1155 mm?
5. **Dotyczy Załącznika Nr 7 punkt 4.** Czy Zamawiający dopuści do postępowania urządzenie, którego obudowa i komora mycia wykonane są w całości ze stali nierdzewnej, wyposażone w dwa plastikowe panele na przedniej powierzchni urządzenia zgodnie z załączonym zdjęciem?

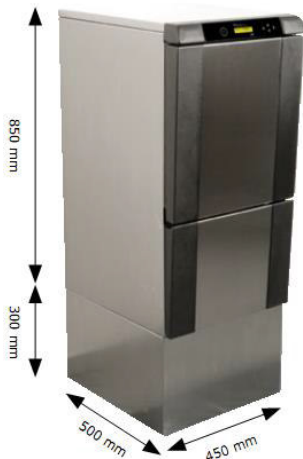

6. **Dotyczy Załącznika Nr 7 punkt 19.** Czy Zamawiający dopuści do postępowania urządzenie posiadające węże ciśnieniowe gumowe gładkie bez oplotu metalowego?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie również myjni-dezynfektorów o wysokości 1775 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 2 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie również myjni-dezynfektorów o pojemności komory: 1 basen z pokrywą (zamiennie za basen nocnik dla dzieci – w cenie oferty 10 nocników, które mogą być myte w zaoferowanej myjni) i 1 kaczka na mocz lub 2 kaczki lub 1 miska do toalety pacjenta lub 2 miski nerkowate” lub 1 pojemnik na mocz, pod warunkiem, że myjnia posiada wszystkie wymienione w pytaniu opcje zestawień sprzętu do mycia i spełniania pozostałe wymagania SIWZ.

Ad. 3 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie myjni-dezynfektorów o wysokości 855 mm.

Ad. 4 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie również myjni- dezynfektorów o wysokości 1155 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ

Ad. 5 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie również myjni-dezynfektorów których obudowa i komora mycia wykonane są w całości ze stali nierdzewnej, wyposażone w dwa plastikowe panele na przedniej powierzchni urządzenia zgodnie z załączonym zdjęciem, pod warunkiem, że panele plastikowe są wyłącznie na zewnętrznej obudowie urządzeń i zaoferowane urządzenia spełniają pozostałe wymagania SIWZ.

Ad. 6 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie myjni-dezynfektorów posiadających węże ciśnieniowe gumowe gładkie bez opłotu metalowego.



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnów ul. Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl
www.ssz.tar.pl - tel.(014) 63 10 100 - fax(014) 621 36 37 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

Bank Spółdzielczy w Rymanowie 91 8636 0005 2001 0008 9164 0001

