



Znak: AE/ZP-27-14/16

Tarnów, 2016-02-04

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 209.000 EURO na dostawy sterylnych: fartuchów, serwet, zestawów obłożeń operacyjnych, osłon na aparaturę oraz czyścików do koagulacji dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164) Zamawiający wprowadza zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

**W Załączniku Nr 1 do SIWZ**

**w Pakiecie Nr 1 poz. 16 dotychczasowy zapis o treści:**

„Obłożenie sterylne do zabiegów ginekologicznych kroczykowych, wykonane z minimum dwuwarstwowego laminatu nieprzemakalnego, chłonnego, o gramaturze 60g/m<sup>2</sup>. Minimalny skład zestawu: serweta o wymiarach 150-170x200-240 cm z otworem 10x15 cm w części kroczykowej otoczony taśmą lepłą, worek do zbiórki płynów z zaworem spustowym - 1 szt., 2 nogawice - mogą być zintegrowane z wymienioną wcześniej serwetą, serweta mogąca służyć jako przykrycie na stół instrumentariuszki o wymiarach 150x180-200 cm, torba do zbiórki płynów z zaworem spustowym - 1 szt.”

**zastępuje się zapisem**

„Obłożenie sterylne do zabiegów ginekologicznych kroczykowych, wykonane z minimum dwuwarstwowego laminatu nieprzemakalnego, chłonnego, o gramaturze 60g/m<sup>2</sup>. Minimalny skład zestawu: serweta o wymiarach 150-170x200-240 cm z otworem 10x15 cm w części kroczykowej otoczony taśmą lepłą, worek do zbiórki płynów z zaworem spustowym - 1 szt., 2 nogawice - mogą być zintegrowane z wymienioną wcześniej serwetą, serweta mogąca służyć jako przykrycie na stół instrumentariuszki o wymiarach 150x180-200 cm.”

**w Pakiecie Nr 1 poz. 17 dotychczasowy zapis o treści:**

„Osłona do aparatu, przezroczysta, sterylna, o średnicy 50-53 cm”

**zastępuje się zapisem**

„Osłona przezroczysta, sterylna, na aparaturę o rozmiarze: szerokość 42 cm, długość 52 cm, wysokość 15 cm, z gumką ściągającą, która umożliwi założenie osłony na aparaturę, a równocześnie utrzymanie osłony na aparaturze (po założeniu osłony gumka znajdzie się na górnej części aparatury)”

**w Pakiecie Nr 1 poz. 19 dotychczasowy zapis o treści:**

Osłona na aparaturę, przezroczysta, sterylna, z gumką 70-80x80-90 cm”

**zastępuje się zapisem**

„Osłona przezroczysta, sterylna, na szybę o rozmiarze: szerokość 60 cm, wysokość 76 cm, z gumką ściągającą na krótszym boku, która umożliwi założenie osłony na szybę, a równocześnie utrzymanie osłony na szybie (po założeniu osłony gumka znajdzie się na górnej części szyby)”

**w Pakiecie Nr 1 poz. 20 dotychczasowy zapis o treści:**

„Serweta sterylna z otworem (7-8 cm) z przylepcem rozmiar 75x75 cm x 90 cm”

**zastępuje się zapisem**

„Serweta sterylna z otworem (7-8 cm) z przylepcem rozmiar 75x75 - 90 cm”

**W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:**

1. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1.** Czy Zamawiający miał na myśli fartuch chirurgiczny pełnobarierowy z zakładanymi połami, złożony w sposób zachowujący „sterylne plecy”?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1.** Czy można zaoferować fartuchy o długościach :M- L-120cm, XL-130cm i XXL-150cm?

3. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety w rozmiarze 150x180cm lub alternatywnie w rozmiarze 150x240cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
4. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 4.** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie sterylnego obłożenia uniwersalnego o następującym składzie i parametrach:
  - 1 serweta na stół instrumentariuszki 150 cm x 190 cm (owinięcie zestawu)
  - 2 ręczniki do rąk 30 cm x 20 cm
  - 1 serweta na stół Mayo 80 cm x 145 cm
  - 1 taśma samoprzylepna 9 cm x 25 cm
  - 2 serwety samoprzylepne 2-warstwowe 75 cm x 90 cm
  - 1 serweta samoprzylepna 2-warstwowa 175 cm x 170 cm
  - 1 serweta samoprzylepna 2-warstwowa 140 cm x 240 cm
  - Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa o gramaturze 48g/m<sup>2</sup>.
  - Materiał obłożenia spełnia normę PN EN 13795.
5. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 4.** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie sterylnego obłożenia uniwersalnego o następującym składzie i parametrach:
  - 1 serweta na stół instrumentariuszki 150 cm x 190 cm (owinięcie zestawu)
  - 2 ręczniki 30 cm x 40 cm
  - 1 serweta na stół Mayo 80 cm x 145 cm
  - 2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 cm x 90 cm
  - 1 samoprzylepna serweta operacyjna 175 cm x 180 cm z paskiem samoprzylepnym 80 cm
  - 1 samoprzylepna serweta operacyjna 150x240cm z dzielonym paskiem samoprzylepnym
  - Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 57,5 g/m<sup>2</sup>.
  - Materiał obłożenia spełnia normę PN EN 13795.
6. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 5.** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu do angiografii o następującym składzie i parametrach:
  - 1 serweta 80 cm x 100 cm (owinięcie zestawu)
  - 1 ręcznik 30 cm x 40 cm
  - 1 włókninowa taśma samoprzylepna 9 cm x 25 cm
  - 1 serweta do angiografii 227 cm x 330 cm z dwoma samoprzylepnymi otworami 12 cm x 12 cm otoczonymi folią operacyjną umieszczonymi decentralnie, średnica każdego otworu 8 cm, ze zintegrowanymi pasami z przezroczystej folii PE po obu stronach serwety przeznaczonymi do okrycia pulpitu pomiarowego stołu angiograficznego. Serweta wykonana z nieprzemakalnego laminatu z warstwą chłonną
7. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 7.** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety z otworem o średnicy 6 cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
8. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 9.** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety w rozmiarze 38x45cm lub serwety w rozmiarze 45x75cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
9. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 10.** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pokrowca foliowego na przewody w rozmiarze 13x250cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
10. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 11.** Czy można zaoferować pokrowiec foliowy w rozmiarach 90x225cm złożony w sposób umożliwiający szybką aplikację w warunkach bloku operacyjnego z taśmami do mocowania?
11. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 12.** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie sterylnego obłożenia do wszczepu endoprotezy stawu biodrowego o następującym składzie i parametrach:
  - 1 serweta na stół instrumentariuszki 150 cm x 190 cm
  - 4 ręczniki 30 cm x 40 cm
  - 1 serweta na stół Mayo Special 80 cm x 145 cm
  - 1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm
  - 1 samoprzylepna serweta operacyjna 75 cm x 90 cm
  - 1 serweta operacyjna 180 cm x 150 cm
  - 1 osłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x 110 cm

2 taśmy foliowe samoprzylepne 10 cm x 50 cm

1 serweta operacyjna wzmocniona samoprzylepna (ekran anestezyjologiczny ) 225 cm x 270 cm z wycięciem "U" 45 cm x 65 cm , z osłoną podpórek kończyn górnych

1 serweta operacyjna wzmocniona samoprzylepna 225 cm x 280 cm z wycięciem "U" 10 cm x 100 cm.

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 57,5 g/m<sup>2</sup>. Wokół pola operacyjnego polipropylenowe łaty chłonne. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 112,5 g/m<sup>2</sup>. Materiał obłożenia spełnia wymagania normy PN EN 13795.

**12. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 13.** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie sterylnego zestawu do artroskopii o następującym składzie i parametrach:

1 serweta na stół instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

2 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stół Mayo 80 cm x 145 cm

1 osłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x 55 cm

1 taśma foliowa samoprzylepna 10 cm x 50 cm

1 serweta operacyjna 180 cm x 150 cm

1 serweta na kończynę 225 cm x 320 cm z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm i dwoma zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 57,5 g/m<sup>2</sup>. Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łata chłonna. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 112,5 g/m<sup>2</sup>. Materiał obłożenia spełnia wymagania normy PN EN 13795.

**13. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 14.** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie sterylnego zestawu do cesarskiego cięcia o następującym składzie i parametrach:

1 serweta na stół instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

2 ręczniki do rąk 30 cm x 20 cm

1 serweta na stół Mayo 80 cm x 145 cm

1 serweta dla noworodka 90 cm x 90 cm

1 serweta do cięcia cesarskiego w kształcie litery "T" 230/200 cm x 312 cm z otworem 27 cm x 33 cm w okolicach jamy brzusznej wypełnionym folią chirurgiczną, otwór okala worek przechwytyjący płyny z kształtkami usztywniającymi brzeg oraz zawór do podłączenia drenu

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Ekran anestezyjologiczny wykonany z folii polietylenowej.

Materiał obłożenia spełnia normę PN EN 13795.

**14. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 14.** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie sterylnego zestawu do cesarskiego cięcia o następującym składzie i parametrach:

1 serweta na stół instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

4 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stół Mayo 80 cm x 145 cm

1 serweta dla noworodka 90 cm x 100 cm z miękkiej włókniny absorbującej płyny

1 serweta do cesarskiego cięcia 260/200 cm x 335 cm, z otworem 27 cm x 33 cm w okolicach jamy brzusznej, z oknem 14 cm x 20 cm otoczonym folią chirurgiczną, otwór okala worek przechwytyjący płyny z kształtkami usztywniającymi brzeg oraz zawór do podłączenia drenu

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa.

Materiał obłożenia spełnia wymagania normy PN EN 13795.

**15. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 15.** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie sterylnego obłożenia uniwersalnego o następującym składzie i parametrach

1 serweta na stół instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

2 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stół Mayo 80 cm x 145 cm

2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 cm x 90 cm




- 1 samoprzylepna serweta operacyjna 175 cm x 180 cm  
 1 samoprzylepna serweta operacyjna 150x240cm  
 1 foliowa kieszeń dwukomorowa 38x40cm pakowana osobno  
 Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 57,5 g/m<sup>2</sup>.  
 Materiał obłożenia spełnia wymagania normy PN EN 13795.
16. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 16.** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie sterylnego obłożenia do zabiegów ginekologicznych o następującym składzie i parametrach  
 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm  
 2 ręczniki 30 cm x 40 cm  
 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm  
 1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm  
 1 serweta samoprzylepna ( folia PE ) 50 cm x 50 cm  
 1 serweta ginekologiczna wzmocniona 230 cm x 240/260 cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne, z otworem na krocze 10 cm x 15 cm, ze zintegrowaną torbą na płyny z sitkiem i zaworem.  
 Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 57,5 g/m<sup>2</sup>. Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łata chłonna. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 112,5 g/m<sup>2</sup>. Materiał obłożenia spełnia wymagania normy PN EN 13795.
17. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 17.** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie sterylnej przezroczystej osłony do aparatu o średnicy 90cm w stanie rozciągniętym?
18. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 20.** Czy zamawiający miał na myśli serwetę o rozmiarze 75x90 cm?
19. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1.** Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie fartuchów chirurgicznych wykonanych z włókniny typu SMMMS, pięciowarstwowych, Oferowane przez nas fartuchy posiadają większą warstwę wewnętrzną, a zatem zapewniają lepszą barierowość przed przenikaniem mikroorganizmów. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
20. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 4.** Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie sterylnego obłożenia posiadającego serwetę dolną o wymiarach nieznacznie różniących się od wymaganych w SIWZ tj. 170 x175 cm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
21. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 5.** Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczanie sterylnego zestawu serwet do angiografii o następujących wymiarach: serweta rozmiar 200x300 cm wykonana z nieprzemakalnej włókniny i dwoma otworami przylepnymi o średnicy 8 cm, owinięta w serwetę nieprzemakalną 140x190 cm.
22. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 10.** Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania pokrowca na przewody o wymiarach 13x250cm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
23. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 12.** Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczanie sterylnego zestawu do endoprotezy stawu biodrowego z serwetą główną wzmocnioną o minimalnych wymiarach 200x260cm z samoprzylepnym wycięciem w kształcie "U" o wymiarach 7cmx95. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
24. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 13.** Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie sterylnego zestawu serwet przeznaczonych do artroskopii kolana posiadającego serwetę główną o wymiarach 200x320cm z elastometrycznym (samouszczelniającym się) owalnym otworem 5x7cm oraz osłoną na kończynę o wym. 25x80cm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ
25. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 14.** Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie sterylnego zestawu serwet do zabiegów cesarskiego cięcia o wymiarach serwety głównej w kształcie T o wym. 200/250x315cm, z przylepnym oknem o wymiarach 18x28x32cm wypełnionym w całości folią chirurgiczną otoczonym torbą do zbiórki płynów z 2 zaworkami spustowymi i kształtownikiem. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
26. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 15.** Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie sterylnego zestawu serwet wykonanych z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu folii PE i włókniny PP o gramaturze 62 g/m<sup>2</sup> o + wzmocnienie: Spunlace 70g/m<sup>2</sup> w składzie ?  
 1 czerwona osłona na stolik Mayo 80x145cm, ze wzmocnieniem 60x85cm o gram. 40 g/m<sup>2</sup>.

- 1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm, wzmocnienie 76x190cm, o gram. 30g, folia PE 0,050mm
- 1 serweta przylepna 150x240cm z przylepną taśmą przy dłuższym boku o wym. 5x90cm, wzmocniona na powierzchni 50x75cm
- 1 serweta przylepna 175x200cm, z przylepną taśmą na krótszym boku o wym. 5x90 cm, wzmocniona na powierzchni min. 50x75cm
- 2 serwety przylepne 75x90cm z przylepną taśmą o wym. 5x90cm, wzmocniona na powierzchni min. 45x60cm
- 1 kieszeń dwukomorowa na instrumenty chirurgiczne **30x40cm**,
- 1 włókninowa taśma samoprzylepna 9x50cm,
- 4 ręczniki celulozowe 30x40cm
27. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 16.** Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie obłożenia do zabiegów ginekologicznych, wykonane z dwuwarstwowego nieprzemakalnego laminatu, chłonnego o gramaturze 62 g/m2 oraz następującym składzie:
- 1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm,
- 1 główna serweta 250/312x290cm, ze zintegrowanymi nogawicami i przylepnym oknem 9x12 cm oraz trójkątną torbą do zbiórki płynów o min wym. 68x50 (wys.) cm z sitem, zaworkiem spustowym i kształtownikiem.
- 1 nieprzylepna serweta pod pośladki 75x90cm,
- 1 włókninowa taśma samoprzylepna 9x50cm,
- 1 ręcznik celulozowy 30x40cm,
28. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 17.** Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie osłony na aparaturę o średnicy 60 cm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
29. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 19.** Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie osłony na aparaturę, przeźroczystej z gumką o średnicy 90 cm.
30. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 20.** Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie serwety sterylnej 75x75 cm z przylepnym otworem o wym. 6x8 cm.
31. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XIV.4 SIWZ.** Zamawiający w SIWZ(XIV. ogólne warunki umowy) zawarł zapis: „Na opakowaniach zestawów (Pakiet Nr 1 poz.: 4, 5, 12-16) muszą być opisy składu zestawu”. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie, czy wystarczający będzie graficzny opis zestawu (ilustracja składu wraz z wymiarami serwet) oraz słowny opis jego przeznaczenia?
32. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów w rozmiarach L, LL, XL, XLL, przy czym wymiary mieszczą się w normach ustalonych dla symboli odpowiednio M, L, XL, XXL?
33. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 2.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety o wymiarze 150cmx240cm?
34. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 4.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby w zestawie serweta dolna miała wymiar 175cm/175cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
35. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 5.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby serweta główna w zestawie miała wymiar 240cm/320cm oraz otwory 6/9cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. Jeśli nie, czy wyrazi zgodę na serwetę 240/370cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
36. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 7.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety o wymiarze 45/75cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
37. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 9.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety o wymiarze 37,5/45cm? Jeśli nie, czy wyrazi zgodę na serwetę 45/75cm?
38. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 10.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pokrowca na przewody w rozmiarze 200cm/17cm?
39. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 11.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pokrowca na przewody na ramię RTG z gumkami do mocowania? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
40. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 12.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zestaw do wszczepu endoprotezy stawu biodrowego w którego serwecie głównej wycięcie „U” ma wymiar 7cm/102cm a osłona na kończyne 32/120cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

41. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 13.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do artroskopii kolana którego serweta główna ma wymiar 230cm/315cm z otworem 7cm oraz osłoną na kończyne 22cm/75cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. Jeśli nie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu w którym serweta główna ma wymiar 200cm/300cm oraz na zaoferowanie osłony na kończyne pakowanej osobno o wymiarze 32cm/120cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
42. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 14.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do cięcia cesarskiego w którym serweta główna posiada wymiar 175cm/250cmx300cm (kształt litery T) z otworem prostokątnym o wymiarze 38cm/32cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. Jeśli nie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do cięcia cesarskiego z serwetą główną o wymiarze 180cm/300cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
43. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 15.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kieszeni foliowej pakowanej osobno dwukomorowej 40cm/35cm?
44. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 15.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kieszeni foliowej pakowanej osobno jednokomorowej 40cm/35cm?
45. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 15.** Czy Zamawiający wyraża zgodę aby serweta do przykrycia stolika instrumentalnego miała wymiar 140cm/190cm?
46. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 13.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do artroskopii kolana którego serweta główna ma wymiar 230 cm/315 cm z otworem 7 cm oraz osłoną na kończyne 22 cm/75 cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. Jeżeli nie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu w którym serweta główna ma wymiar 200 cm/300 cm oraz zaoferowanie osłony na kończyne pakowanej osobno. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie jednego z rozmiarów dostępnych w naszej ofercie: 22/75 cm, 32/120 cm, 37/75 cm, 37/105 cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
47. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 4.** Czy zamawiający dopuści sterylne obłożenie uniwersalne wykonane z nieprzemakalnego, chłonnego materiału o gramaturze minimum 56g/m2 spełniającego wymagania normy EN 13795 w wymagań dla strefy krytycznej?
48. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 4.** Czy zamawiający dopuści zestaw składający się z minimum: serwety dolnej o wymiarach 10x175 cm z przylepcem, serwety górnej o wymiarach 150 x200-240 cm z przylepcem, 2 serwet bocznych o wymiarach 75x90 cm z przylepcem, serweta do nakrycia stolika Mayo, wykonanej z nieprzemakalnego materiału z warstwą chłonną, rozmiar 75 - 90 cm x 140-150 cm; całość owinięta w serwetę nieprzemakalną 130-160 cm x 170-210 cm?
49. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 5.** Czy zamawiający dopuści serwetę o wymiarach 230x350cm, pozostałe parametry bez zmian?
50. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 8.** Czy zamawiający dopuści rozmiar 75 - 90 cm x 140-150 cm?
51. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 10.** Czy zamawiający dopuści rozmiar 200-250 x16-18 cm?
52. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 12.** Czy zamawiający dopuści sterylne obłożenie uniwersalne wykonane z nieprzemakalnego, chłonnego materiału o gramaturze minimum 56g/m2 spełniającego wymagania normy EN 13795 w wymagań dla strefy krytycznej?
53. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 12.** Czy zamawiający dopuści zestaw składający się z minimum: serwety o wymiarach 200-220 x 250-290 cm z wycięciem w kształcie litery U o wymiarach 6-10x85-100 cm z taśmą samoprzylepną; serwety o wym. 150-175x200-300 z taśmą samoprzylepną, serwety na stolik Mayo o wymiarach 75- 90 x 140-150 cm, serwety na stolik instrumentariuszki o wymiarach 100-150x150-200 cm, osłony na nogę o wymiarach 33-40x105-120 cm, 2 taśm samoprzylepnych o wymiarach 9-10x49-51 cm?
54. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 13.** Czy zamawiający dopuści sterylne obłożenie uniwersalne wykonane z nieprzemakalnego, chłonnego materiału o gramaturze minimum 56g/m2 spełniającego wymagania normy EN 13795 w wymagań dla strefy krytycznej?
55. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 13.** Czy zamawiający dopuści zestaw składający się z minimum: serweta do artroskopii o wymiarach 180-220x320 cm, z elastycznym otworem o wymiarach 6-8x6-8 cm, osłony na nogę o wymiarach 22-40x60-90 cm, serweta na stolik instrumentariuszki o wymiarach 100-150x150-200 cm, serwety do nakrycia stolika Mayo o wymiarach 75 - 90 cm x 140-150, cm, taśmy przylepnej o wymiarach 9-10x49-51cm

56. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 14.** Czy zamawiający dopuści minimalny skład i wymiary: serweta główna o wymiarach 180-200 x 300-310 cm, w części centralnej z otworem o wymiarach 20-25x30-40x20-30cm wypełnionym folią chirurgiczną, otwór okala worek przechwytyjący płyny (z usztywnionym brzegiem, wyposażony w zawór do podłączenia drenu) - 1 sztuka; obłożenie na stół Mayo 75-90x140-150 cm - 1 sztuka; całość owinięta w serwetę o wymiarach 100-150 x 150-200 cm, służącą jako przykrycie stołka instrumentalnego - 1 sztuka?
57. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 15.** Czy zamawiający dopuści sterylne obłożenie uniwersalne wykonane z nieprzemakalnego, chłonnego materiału o gramaturze minimum 56g/m<sup>2</sup> spełniającego wymagania normy EN 13795 w wymagań dla strefy krytycznej?
58. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 15.** Czy zamawiający dopuści zestaw składający się z minimalny skład i wymiary: serweta górna o wymiarach 150 x 240 cm z taśmą samoprzylepną - 1 sztuka; serweta dolna o wymiarach 175 x 175 cm z taśmą samoprzylepną - 1 sztuka; serweta boczna o wymiarach 75-80 x 90-100cm z taśmą samoprzylepną na całej długości boku – 2 sztuki; serweta do nakrycia stołka Mayo, wykonanej z nieprzemakalnego materiału z warstwą chłonną, rozmiar 75 - 90 cm x 140-150 cm, taśma samoprzylepna 9-10 x 49-51 cm - 1 sztuka; kieszeń foliowa samoprzylepna w rozmiarze 30-40 x 50 cm dwukomorowa - 1 szt. lub zamiennie kieszeń foliowa samoprzylepna jednokomorowa rozmiar 30-40x20-25 cm - 2 szt.; zestaw owinięty w serwetę 150 x 190-200 cm mogącą służyć jako przykrycie stołka instrumentalnego - 1 sztuka?
59. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 16.** Czy zamawiający dopuści sterylne obłożenie uniwersalne wykonane z nieprzemakalnego, chłonnego materiału o gramaturze minimum 56g/m<sup>2</sup> spełniającego wymagania normy EN 13795 w wymagań dla strefy krytycznej?
60. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 16.** Czy zamawiający dopuści zestaw składający się z minimum Minimalny skład zestawu: serweta o wymiarach 150-170x200-280 cm z otworem 7-10x15 cm w części kroczonej otoczony taśmą lepna, worek do zbiórki płynów z zaworem spustowym - 1 szt., 2 nogawice - mogą być zintegrowane z wymienioną wcześniej serwetą.
61. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 10.** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 1 poz.10 Sterylnej, jednorazowej osłony na kamerę. Wymiar 15 (+/- 1cm). cm na 240cm(+/- 1cm)..Zaopatrzonej w teksturę ułatwiającą zakładanie składanej teleskopowo. Końcówka perforowana zaopatrzona w nierozmakające taśmy mocujące.
62. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 11.** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 1 poz.11 sterylnej, jednorazowej osłony na aparat RTG o Wymiarach 104 (+/- 1cm). cm na 188cm(+/- 1cm). Zaopatrzona w nierozmakające taśmy mocujące
63. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 17.** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 1 poz.17 jałowej osłona na aparaturę o średnicy 50cm z gumką.
64. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 19.** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 1 poz.19 sterylnej worka z gumką, prostokątnego, o wymiarach 91cm na 76cm.
65. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz.: 10, 11, 17, 19.** Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do odrębnego pakietu.
66. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartuchów chirurgicznych wykonanych z włókniny wysokobariowej typu SMMMS, co oznacza włókninę SMS ze wzmocnioną warstwą wewnętrzną?
67. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz.: 4, 5, 12, 13, 14, 15, 16.** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawów wykonanych z nieprzemakalnego laminatu 2-warstwowego o minimalnej gramaturze 55 g/m<sup>2</sup> w strefach wzmocnionych o gramaturze 110 g/m<sup>2</sup>, spełniających wszystkie pozostałe wymogi obowiązujących norm dotyczące nieprzemakalności i wytrzymałości na rozierwanie.
68. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 4.** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu uniwersalnego w następującym składzie:
- 1 serweta na stół narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm
  - 1 serweta na stół Mayo wzmocniona 80 x 145 cm
  - 1 samoprzylepna serweta operacyjna 200 x 175 cm
  - 1 samoprzylepna serweta operacyjna 150 x 240 cm

- 2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 x 90 cm  
 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm  
 4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm ?
69. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 5.** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do angiografii w następującym składzie:

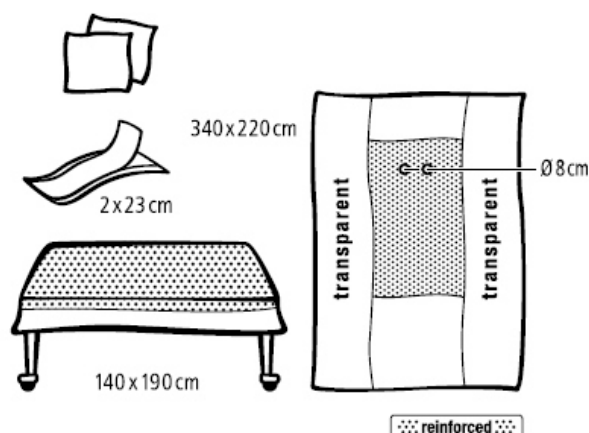


#### Zestaw I do angiografii wzmocniony

##### Skład zestawu:

|                                                                                                |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona                                                     | 140 x 190 |
| 1 serweta angiograficzna z padem chłonnym i dwoma otworami (8 cm). Folia na pulpit obustronnie | 340 x 220 |
| 1 uchwyt Velcro                                                                                | 2 x 23    |
| 2 ręczniki celulozowe                                                                          | 30 x 33   |

Miejsca wykropkowane – obszary wzmocnione

70. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 10.** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania pokrowców foliowych na przewody w rozmiarze 14 x 250 cm, pozostałe parametry spełnione ?
71. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 11.** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania pokrowców foliowych na przewody w rozmiarze 14 x 250 cm, pozostałe parametry spełnione ?
72. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 12.** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do wszczepu endoprotezy stawu biodrowego w następującym składzie:  
 1 serweta na stolik Mayo wzmocniona, złożona teleskopowo, rozmiar 80 x 145 cm (+5 cm)  
 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona, rozmiar 150 cm x 190 cm (+/- 5cm)  
 1 serweta z padem chłonnym rozm. 260 x 200 cm, otwór typu "U" przylepny 15 x 95 cm  
 1 serweta samoprzylepna rozmiar 200 x 170 cm  
 1 osłona na kończynę rozmiar 35 x 120 cm ?
73. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 13.** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do artroskopii kolana w następującym składzie:

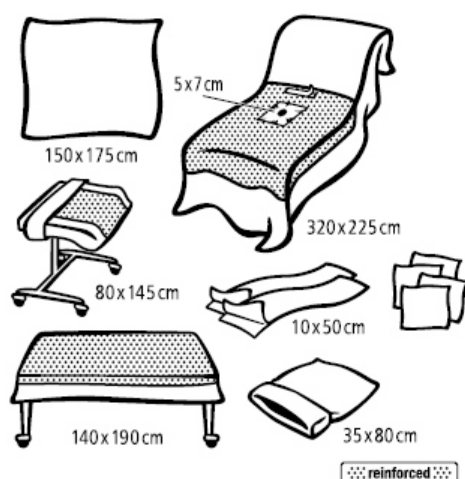


#### Zestaw do zabiegów na kończynie I wzmocniony

##### Skład zestawu:

|                                                                                          |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona                                               | 140 x 190 |
| 1 serweta na stolik Mayo wzmocniona                                                      | 80 x 145  |
| 1 serweta do operacji kończyny z padem chłonnym z samouszczelniającym otworem (5 x 7 cm) | 320 x 225 |
| 1 serweta nieprzylepna                                                                   | 150 x 175 |
| 1 osłona na kończynę                                                                     | 35 x 80   |
| 2 taśmy samoprzylepne                                                                    | 10 x 50   |
| 4 ręczniki celulozowe                                                                    | 30 x 33   |

Miejsca wykropkowane – obszary wzmocnione

74. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 14.** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do cięcia cesarskiego w ułożeniu na płasko w następującym składzie:
- 1 serweta dwuwarstwowa do nakrycia stołu instrumentariuszki 150 x 200 cm (opakowanie zestawu)
  - 1 serweta do nakrycia stolika Mayo 80 x 145 cm
  - 1 serweta dwuwarstwowa do cięcia cesarskiego z torbą na płyny oraz oknem 29 x 19 cm wypełnionym folią chirurgiczną 250x315 cm (ułożenie płasko na stole)
  - 1 chłonna serweta dla noworodka 87 x 90 cm
  - 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm
  - 2 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm ?
75. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 15.** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu uniwersalnego w następującym składzie:
- 1 serweta do nakrycia stolika Mayo 80 x 145 cm
  - 1 serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki wzmocniona 140 x 190 cm (opakowanie zestawu)
  - 1 serweta samoprzylepna dwuwarstwowa 200 x 170 cm
  - 1 serweta samoprzylepna dwuwarstwowa 175 x 170 cm
  - 2 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm
  - 1 kieszeń samoprzylepna (2sekcje) 43 x 38 cm
  - 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm
  - 2 serwety samoprzylepne dwuwarstwowa 90 x 75 cm ?
76. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 15.** Czy Zamawiający dopuści zestaw w składzie:

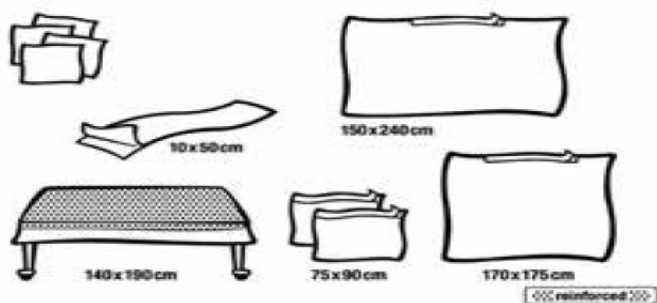

#### Zestaw uniwersalny I


##### Skład zestawu:

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| 1 serweta na stół narzędziowy wzmocniona | 140 x 190 |
| 1 samoprzylepna serweta operacyjna       | 150 x 240 |
| 1 samoprzylepna serweta operacyjna       | 170 x 175 |
| 2 samoprzylepne serwety operacyjne       | 75 x 90   |
| 1 taśma samoprzylepna                    | 10 x 50   |
| 4 ręczniki celulozowe                    | 30 x 33   |

*Miejsca wykropkowane – obszary wzmocnione*

Oraz dodatkowo niezależnie pakowana jednokomorowa kieszeń w rozmiarze 43 x 38 cm załączona do zestawu?

77. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 16.** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do zabiegów ginekologicznych w następującym składzie:

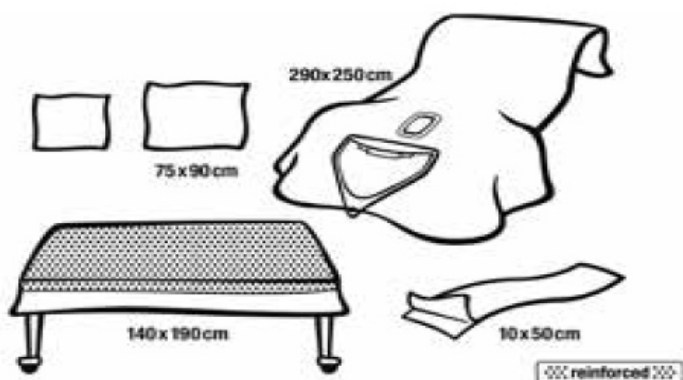

#### Zestaw ginekologiczny z workiem zbierającym płyn

##### Skład zestawu:

|                                                                                          |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1 serweta na stół narzędziowy wzmocniona                                                 | 140 x 190 |
| 1 samoprzylepna serweta ginekologiczna z workiem do zbiórki płynów i otworem (9 x 12 cm) | 290 x 250 |
| 1 nieprzylepna serweta do podłożenia pod pośladki                                        | 75 x 90   |
| 1 taśma samoprzylepna                                                                    | 10 x 50   |
| 1 ręcznik celulozowy                                                                     | 30 x 33   |
| Opakowanie dodatkowe - papier krepowy                                                    |           |

*Miejsca wykropkowane – obszary wzmocnione*

78. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 17.** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania osłony do aparatu w rozmiarze 50 x 100 cm ?
79. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 19.** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania osłony do aparatu w rozmiarze 85 x 150 cm?
80. **Dotyczy pytań 66-79.** W przypadku negatywnych odpowiedzi na którekolwiek z pytań 66-79, prosimy Zamawiającego o ich wyłączenie z Pakietu i utworzenie dla nich odrębnego przedmiotu zamówienia.
81. **Dotyczy Pakietu Nr 1.** Czy Zamawiający wymaga, aby oferowane w pakiecie nr 1 zestawy obłożeń, serwety i odzież operacyjna spełniały wymogi normy EN 13795 1, 2, 3, obowiązującej w stosunku do materiałów barierowych stosowanych na bloku operacyjnym ? Czy fakt spełniania wymogów w/w normy należy potwierdzić stosownymi dokumentami dołączonymi do oferty ?
82. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu w następującym składzie:  
2 x uchwyt Velcro 2 x 23 cm  
2 x czyścik do koagulacji 5 x 5 cm (kontrastuje w RTG)?
83. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie w/w pozycji z pakietu i utworzenie odrębnego zadania?
84. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XIV.9.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary w pkt 9 ogólnych warunków umowy w SIWZ z 20% na 10%.

**Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:**

**Ad. 1** Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 1** fartuchów chirurgicznych pełnobarierowych z zakładanymi połami, złożonych w sposób zachowujący „sterylne plecy”, pod warunkiem spełniania wymagań SIWZ, w tym zaoferowane fartuchy są zapakowane sterylnie.

**Ad. 2** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 1** fartuchów o długościach: L-120cm, XL-130cm i XXL-150cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

**Ad. 3** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 2** serwety w rozmiarze 150x240cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

**Ad. 4** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 pozycji 4** opisanego w pytaniu sterylnego zestawu uniwersalnego, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

**Ad. 5** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 pozycji 4** opisanego w pytaniu sterylnego zestawu uniwersalnego, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

**Ad. 6** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 pozycji 5** opisanego w pytaniu zestawu do angiografii, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ..

**Ad. 7** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 7** serwety z otworem o średnicy 6 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

**Ad. 8** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 9** serwety w rozmiarze 38 cmx45 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

**Ad. 9** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 10** pokrowca foliowego na przewody w rozmiarze 13x250cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

**Ad. 10** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 11** pokrowca foliowego w rozmiarach 90x225cm złożonego w sposób umożliwiający szybką aplikację w warunkach bloku operacyjnego z taśmami do mocowania, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ

**Ad. 11** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 pozycji 12** opisanego w pytaniu sterylnego obłożenia do wszczepu endoprotezy stawu biodrowego, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

**Ad. 12** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 pozycji 13** opisanego w pytaniu sterylnego zestawu do artroskopii, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

**Ad. 13** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 pozycji 14** opisanego w pytaniu sterylnego zestawu do cesarskiego cięcia, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.



**Ad. 14** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 pozycji 14** opisanego w pytaniu sterylnego zestawu do cesarskiego cięcia, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

**Ad. 15** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 15** sterylnego obłożenia uniwersalnego opisanego w pytaniu, pod warunkiem dołączenia do zestawu taśmy samoprzylepnej w rozmiarze 9-10cmx 49-50cm, a ponadto spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

**Ad. 16** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 pozycji 16** opisanego w pytaniu sterylnego obłożenia do zabiegów ginekologicznych, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

**Ad. 17** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 pozycji 17** sterylnej przezroczystej osłony do aparatu o średnicy 90 cm w stanie rozciągniętym, pod warunkiem, że można ją założyć na aparaturę o rozmiarze: szerokość 42 cm, długość 52 cm, wysokość 15 cm, jest z gumką ściągającą, która umożliwi założenie osłony na aparaturę, a równocześnie utrzymanie osłony na niej gdy po założeniu osłony gumka znajdzie się na górnej części aparatury, a ponadto spełniania pozostałe wymagania SIWZ.

**Ad. 18** Zamawiający w **Pakiecie Nr 1 pozycja 20** miał na myśli sterylną serwetę w rozmiarze 75x75-90 z otworem (7-8 cm) z przylepcem, tak więc dopuszcza zaoferowanie serwety w rozmiarze 75x90 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

**Ad. 19** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 pozycji 1** fartuchów chirurgicznych wykonanych z włókniny typu SMMMS, pięciowarstwowych, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

**Ad. 20** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 pozycji 4** sterylnego obłożenia uniwersalnego z serwetą dolną o wymiarach 170x175 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

**Ad. 21** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 pozycji 5** opisanego w pytaniu sterylnego zestawu serwet do angiografii, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

**Ad. 22** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 pozycji 10** pokrowca na przewody o wymiarach 13x250 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

**Ad. 23** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 pozycji 12** sterylnego zestawu do endoprotezy stawu biodrowego z serwetą główną wzmocnioną o minimalnych wymiarach 200x260cm z samoprzylepnym wycięciem w kształcie "U" o wymiarach 7cmx95cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

**Ad. 24** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 pozycji 13** sterylnego zestawu serwet przeznaczonych do artroskopii kolana posiadającego serwetę główną o wymiarach 200x320cm z elastometrycznym (samouszczelniającym się) owalnym otworem 5x7cm oraz osłoną na kończynę o wym. 25x80cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

**Ad. 25** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 pozycji 14** sterylnego zestawu serwet do zabiegów cesarskiego cięcia o wymiarach serwety głównej w kształcie T o wym. 200/250x315cm, z przylepnym oknem o wymiarach 18x28x32cm wypełnionym w całości folią chirurgiczną otoczonym torbą do zbiórki płynów z 2 zaworkami spustowymi i kształtownikiem, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

**Ad. 26** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 pozycji 15** opisanego w pytaniu sterylnego zestawu serwet, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

**Ad. 27** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 pozycji 16** opisanego w pytaniu obłożenia do zabiegów ginekologicznych, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

**Ad. 28** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 pozycji 17** osłony na aparaturę o średnicy 60 cm, pod warunkiem, że można ją założyć na aparaturę o rozmiarze: szerokość 42 cm, długość 52 cm, wysokość 15 cm, jest z gumką ściągającą, która umożliwi założenie osłony na aparaturę, a równocześnie utrzymanie osłony na niej gdy po założeniu osłony gumka znajdzie się na górnej części aparatury, a ponadto spełniania pozostałe wymagania SIWZ..

**Ad. 29** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 pozycji 19** osłony na aparaturę, przezroczystej z gumką o średnicy 90 cm, pod warunkiem, że można ją założyć na szybę o rozmiarze: szerokość 60 cm, wysokość 76 cm, jest z gumką ściągającą na krótszym boku, która umożliwi założenie



osłony na szybę, a równocześnie utrzymanie osłony na szybie (po założeniu osłony gumka znajdzie się na górnej części szyby), a ponadto osłona spełnia pozostałe wymagania SIWZ.

**Ad. 30** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 pozycji 20** serwety sterylnej 75 x 75 cm z przyklepnym otworem o wym. 6x8 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

**Ad. 31** Zamawiający dopuszcza aby opis na opakowaniach zestawów oferowanych w **Pakiecie Nr 1 poz.: 4, 5, 12-16** był w formie graficznej (ilustracja składu wraz z wymiarami serwet) oraz słowny opis jego przeznaczenia.

**Ad. 32** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 pozycji 1** fartuchów w rozmiarach L, LL, XL, XLL, przy czym wymiary mieszczą się w normach ustalonych dla symboli odpowiednio M, L, XL, XXL, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

**Ad. 33** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 pozycji 2** serwet o wymiarze 150cmx240cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

**Ad. 34** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 pozycji 4** sterylnego obłożenia uniwersalnego z serwetą dolną o wymiarach 170x175 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

**Ad. 35** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 pozycji 5** zestawu serwet zabiegowych do angiografii z serwetą główną o wymiarach 240 cm/320 cm oraz otwory 6/9 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

**Ad. 36** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 pozycji 7** serwety o wymiarze 45/75 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

**Ad. 37** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 pozycji 9** serwety o wymiarze 37,5/45 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

**Ad. 38** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 pozycji 10** pokrowca na przewody w rozmiarze 200 cm/17 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

**Ad. 39** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 pozycji 11** pokrowca na przewody na ramię RTG z gumkami do mocowania, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

**Ad. 40** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 pozycji 12** sterylnego zestawu do endoprotezy stawu biodrowego, w którym serweta główną ma wycięcie w kształcie „U” o wymiarach 7cm/102 cm i osłoną na nogę o wymiarach 32/120 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

**Ad. 41** dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 pozycji 13** sterylnego zestawu do artroskopii kolana, którego serweta główna ma wymiar 230cm/315cm z otworem 7cm, pod warunkiem spełniania dołączenia do niej (może być pakowana oddzielnie) osłony na kończynę w rozmiarze 37x 75 cm, a ponadto spełniania pozostałe wymagania SIWZ.

**Ad. 42** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 pozycji 14** zestawu do cięcia cesarskiego w którym serweta główna posiada wymiar 175cm/250cmx300cm (kształt litery T) z otworem prostokątnym o wymiarze 38cm/32cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

**Ad. 43** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 pozycji 15** zestawu serwet uniwersalnych spełniających wymagania SIWZ z pakowaną osobno kieszenią dwukomorową o wymiarach 40 cm/35 cm.

**Ad. 44** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 pozycji 15** zestawu serwet uniwersalnych spełniających wymagania SIWZ z pakowaną osobno kieszenią jednokomorową o wymiarach 40 cm/35 cm, pod warunkiem zaoferowania dwóch takich kieszeni do każdego zestawu.

**Ad. 45** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 pozycji 15** zestawu serwet uniwersalnych z serwetą do przykrycia stolika instrumentalnego o wymiarach 140 cm/190 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

**Ad. 46** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 13** zaoferowanie zestawu do artroskopii kolana którego serweta główna ma wymiar 230 cm/315 cm z otworem 7 cm pod warunkiem załączenia do niego (dopuszcza się oddzielnie pakowaną) osłony na kończynę o wymiarach 37/75cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie zestawu z serwetą główną o wymiarach 200 cm/300 cm.



**Ad. 47** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 pozycji 4** sterylnych obłożeń uniwersalnych wykonanych z nieprzemakalnego, chłonnego materiału o gramaturze minimum 56g/m2 spełniającego wymagania normy EN 13795 w zakresie wymagań dla strefy krytycznej.

**Ad. 48** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 pozycji 4** zestawu serwet uniwersalnych składającego się z minimum: serwety dolnej o wymiarach 180x175 cm (a nie jak proponował Wykonawca 10x175 cm) z przylepcem, serwety górnej o wymiarach 150 x200-240 cm z przylepcem, 2 serwet bocznych o wymiarach 75x90 cm z przylepcem, serweta do nakrycia stolika Mayo, wykonanej z nieprzemakalnego materiału z warstwą chłonną, rozmiar 75 - 90 cm x 140-150 cm; całość owinięta w serwetę nieprzemakalną 130-160 cm x 170-210 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

**Ad. 49** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 pozycji 5** zestawu serwet do angiografii z serwetą o rozmiarze 230x350cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

**Ad. 50** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 pozycji 8** serwety o rozmiarze 75-90 cmx140-150cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

**Ad. 51** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 pozycji 10** pokrowców na przewody w rozmiarze 200-250 cmx16-18 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ..

**Ad. 52** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 pozycji 12** sterylnego zestawu serwet do wszczepu endoprotezy stawu biodrowego wykonanych z nieprzemakalnego, chłonnego materiału o gramaturze minimum 56g/m2 spełniającego wymagania normy EN 13795 w zakresie wymagań dla strefy krytycznej, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

**Ad. 53** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 pozycji 12** opisanego w pytaniu sterylnego zestawu serwet do wszczepu endoprotezy stawu biodrowego, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

**Ad. 54** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 pozycji 13** sterylnego zestawu serwet do artroskopii kolana wykonanych z nieprzemakalnego, chłonnego materiału o gramaturze minimum 56g/m2 spełniającego wymagania normy EN 13795 w zakresie wymagań dla strefy krytycznej, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ..

**Ad. 55** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 pozycji 13** opisanego w pytaniu sterylnego zestawu serwet do artroskopii, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

**Ad. 56** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 pozycji 14** opisanego w pytaniu sterylnego zestawu serwet do zabiegu cesarskiego cięcia, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

**Ad. 57** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 pozycji 15** sterylnego zestawu serwet uniwersalnych wykonanych z nieprzemakalnego, chłonnego materiału o gramaturze minimum 56g/m2 spełniającego wymagania normy EN 13795 w zakresie wymagań dla strefy krytycznej, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

**Ad. 58** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 pozycji 15** opisanego w pytaniu sterylnego zestawu serwet uniwersalnych, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

**Ad. 59** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 pozycji 16** sterylnego zestawu serwet do zabiegów ginekologicznych wykonanych z nieprzemakalnego, chłonnego materiału o gramaturze minimum 56g/m2 spełniającego wymagania normy EN 13795 w zakresie wymagań dla strefy krytycznej, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

**Ad. 60** dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 pozycji 16** opisanego w pytaniu sterylnego zestawu, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, w tym załączenia do zestawu serwety na stół instrumentariuszki o wymiarach 150x180-200 cm (może być pakowana oddzielnie).

**Ad. 61** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 pozycji 10** opisaną w pytaniu osłonę na przewody, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

**Ad. 62** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 pozycji 11** opisaną w pytaniu osłonę na aparat RTG, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

**Ad. 63** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 pozycji 17** jałowej osłony na aparaturę o średnicy 50 cm z gumką, pod warunkiem, że można ją założyć na aparaturę o rozmiarze: szerokość 42 cm, długość 52 cm, wysokość 15 cm, jest z gumką ściągającą, która umożliwi założenie osłony na

aparaturę, a równocześnie utrzymanie osłony na niej gdy po założeniu osłony gumka znajdzie się na górnej części aparatury, a ponadto spełniania pozostałe wymagania SIWZ.

**Ad. 64** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 pozycji 19** sterylnego worka z gumką, prostokątnego, o wymiarach 91 cm na 76 cm, pod warunkiem, że można ją założyć na szybę o rozmiarze: szerokość 60 cm, wysokość 76 cm, jest z gumką ściągającą na krótszym boku, która umożliwi założenie osłony na szybę, a równocześnie utrzymanie osłony na szybie (po założeniu osłony gumka znajdzie się na górnej części szyby), a ponadto osłona spełnia pozostałe wymagania SIWZ..

**Ad. 65** Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu Nr 1 poz.: 10, 11, 17, 19 do oddzielnego pakietu.

**Ad. 66** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 pozycji 1** fartuchów chirurgicznych wykonanych z włókniny wysokobarierowej typu SMMMS, co oznacza włókninę SMS ze wzmocnioną warstwą wewnętrzną, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

**Ad. 67** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz.: 4, 5, 12, 13, 14, 15, 16** zestawów wykonanych z nieprzemakalnego laminatu 2-warstwowego o minimalnej gramaturze 55 g/m<sup>2</sup> w strefach wzmocnionych o gramaturze 110 g/m<sup>2</sup>, spełniających wszystkie pozostałe wymogi obowiązujących norm dotyczące nieprzemakalności i wytrzymałości na rozerwanie, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

**Ad. 68** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 pozycji 4** opisanego w pytaniu zestawu sterylnych obłożeń uniwersalnych, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

**Ad. 69** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 pozycji 5** opisanego w pytaniu zestawu sterylnych serwet do angiografii, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

**Ad. 70** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 pozycji 10** pokrowców foliowych na przewody w rozmiarze 14 x 250 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

**Ad. 71** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 11** pokrowców foliowych na przewody w rozmiarze 14 x 250 cm.

**Ad. 72** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 pozycji 12** opisanego w pytaniu zestawu do wszczepu endoprotezy stawu biodrowego, pod warunkiem dołączenia do zestawu (mogą być pakowane oddzielnie ) dwóch taśm samoprzylepnych o wymiarach 9-10x49-50 cm, a ponadto spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

**Ad. 73** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 pozycji 13** opisanego w pytaniu zestawu do artroskopii kolana, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

**Ad. 74** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 14** opisanego w pytaniu zestawu do cięcia cesarskiego.

**Ad. 75** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 15** opisanego w pytaniu zestawu uniwersalnego.

**Ad. 76** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 15** opisanego w pytaniu zestawu uniwersalnego.

**Ad. 77** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 16** opisanego w pytaniu zestawu uniwersalnego.

**Ad. 78** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 pozycji 17** osłony na aparat w rozmiarze 50x100 cm, pod warunkiem, że można ją założyć na aparaturę o rozmiarze: szerokość 42 cm, długość 52 cm, wysokość 15 cm, jest z gumką ściągającą, która umożliwi założenie osłony na aparaturę, a równocześnie utrzymanie osłony na niej gdy po założeniu osłony gumka znajdzie się na górnej części aparatury, a ponadto spełniania pozostałe wymagania SIWZ.

**Ad. 79** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 pozycji 19** osłony na aparat w rozmiarze 85x150 cm, pod warunkiem, że można ją założyć na szybę o rozmiarze: szerokość 60 cm, wysokość 76 cm, jest z gumką ściągającą na krótszym boku, która umożliwi założenie osłony na szybę, a równocześnie utrzymanie osłony na szybie (po założeniu osłony gumka znajdzie się na górnej części szyby), a ponadto osłona spełnia pozostałe wymagania SIWZ.

**Ad. 80** Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z **Pakietu Nr 1** jakiegokolwiek pozycji do odrębnego pakietu.

**Ad. 81** Zamawiający określił wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia w SIWZ i Załączniku Nr 1 do niej, w tym dotyczące spełniania normy 13795 i nie wprowadza zmian w tym zakresie.



**Ad. 82** dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 pozycji 1** zestawu w następującym składzie:  
2 x uchwyt Velcro 2 x 23 cm , 2 x czyścik do koagulacji 5 x 5 cm (kontrastuje w RTG), pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

**Ad. 83** Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z **Pakietu Nr 1** i utworzenie odrębnego pakietu.

**Ad. 84** Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do ogólnych warunków umowy, w sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

W związku z dokonaną zmianą treści SIWZ w Załączniku Nr 1 w pakiecie Nr 1 poz.: 16, 17, 19, 20 oraz udzielonymi odpowiedziami: w Ad. 17, Ad 28, Ad29, ad 63, Ad.64, Ad 78, Ad.79 działając na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a oraz art. 12a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert na:

składania ofert do dnia 15 lutego 2016 r. godz. 10<sup>00</sup>

otwarcia ofert w dniu 15 lutego 2016 r. godz. 10<sup>10</sup>

oraz dokonuje odpowiednio zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie III.11, IX.1, X.1, Załącznika Nr 1 oraz zmiany ogłoszenia o zamówieniu

**W załączeniu Załącznik Nr 1 po zmianach**

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnów ul.Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl  
www.ssz.tar.pl - tel.(014) 63 10 100 - fax(014) 621 36 37 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

Bank Spółdzielczy w Rymanowie 91 8636 0005 2001 0008 9164 0001

